

Dott.ssa Maria Letizia Salvetat

Specialista in Oculistica

Via Montereale, 24 - 33170 Pordenone

Tel 0434 399263 Fax 0434 399752 e-mail: marialetizia.salvetat@asfo.sanita.fvg.it

Sig.

PERISSINOTTO ALESSANDRO

VIA A. MEUCCI 3/6

33170 PORDENONE PN

Nascita : 16/06/1977

C.F. PRSLSN77H16G914G Tel. 3498482787 3477295572

Cartella n° 55046 - Ocul

Prestazioni in libera professione eseguite in data : 07/05/2026

Visita oculistica

Fastidio saltuario OD.

TAC orbite con mdc del 16/08/23: in OD neoformazione cistica nel contesto di ghiandola lacrimale. Riferito controllo di RMN della cisti della gh lacrimale nel 2025.

VOD: 10/10 cc -2.25 sf ^ -0.75/75°

VOS: 10/10 cc -2.25 sf ^ -0.75/75° tabo

aggiunto +2.00 sf per vicino in lenti tipo OFFICE

TOO: 14 mmHg

SAOO: piccola cisti sierosa canto esterno OD; per il resto nei limiti;

Fundus OO: nei limiti.

Consiglio:

1) Thealoz Total collirio, 1 goccia x 3 al dì OD a continuare

2) Thealoz Gel, 1 applicazione alla notte prima di dormire OD a continuare.

Cordiali saluti

Il Medico

Dott.ssa Maria Letizia Salvetat

Pordenone, li 07/05/2026

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da MARIA LETIZIA SALVETAT, in data 07/05/2026 alle ore 15:44 (data e ora di sistema). Numero Certificato di firma digitale 69183060251833374960659777382920290639, rilasciato dal Certificatore Actalis S.p.A..

Dott.ssa MARIA LETIZIA SALVETAT

Medico Chirurgo Specialista in Oculistica

Dirigente Medico S.O.C. di Oculistica

A.A.S.5 "Friuli Occidentale" - Ospedale S. Maria degli Angeli - Pordenone

E- Mail.: mlsalvetat@hotmail.it - Cell. 348.8830253


Riceve su appuntamento: Tel. 04 34 223 522

PRESCRIZIONE LENTI


7/5/2026

Sig/Sig.ra PERIJJINOTTO ALESSANDRO

☒ TABO

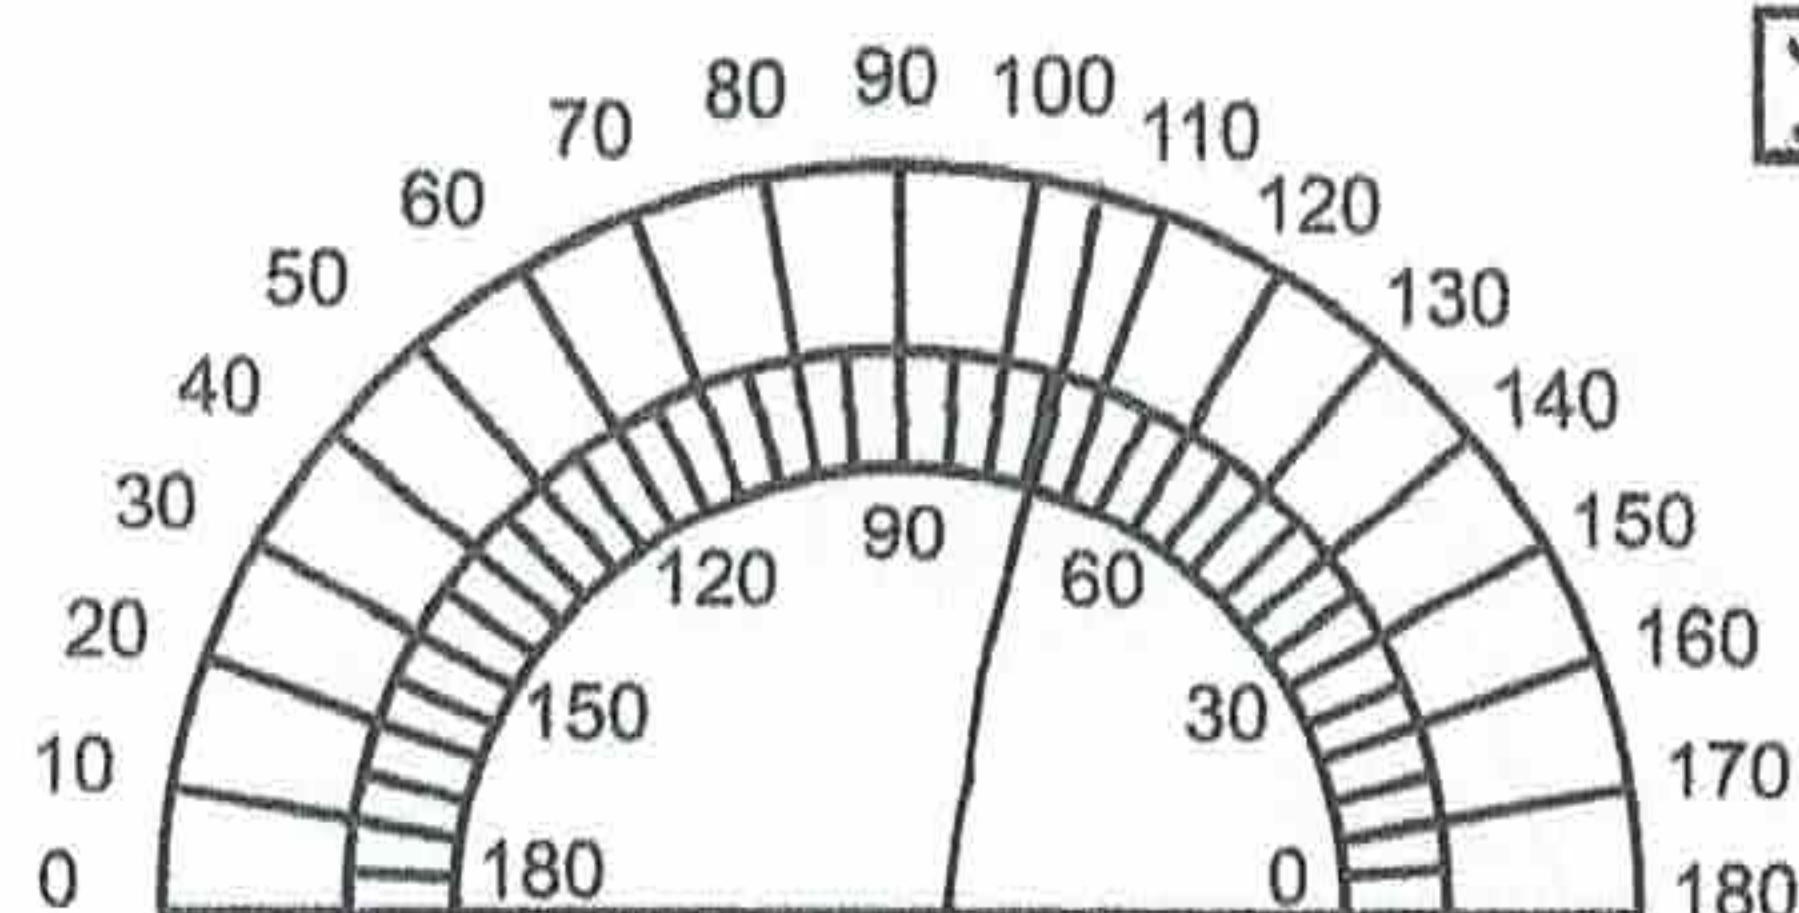

OCCHIO DESTRO

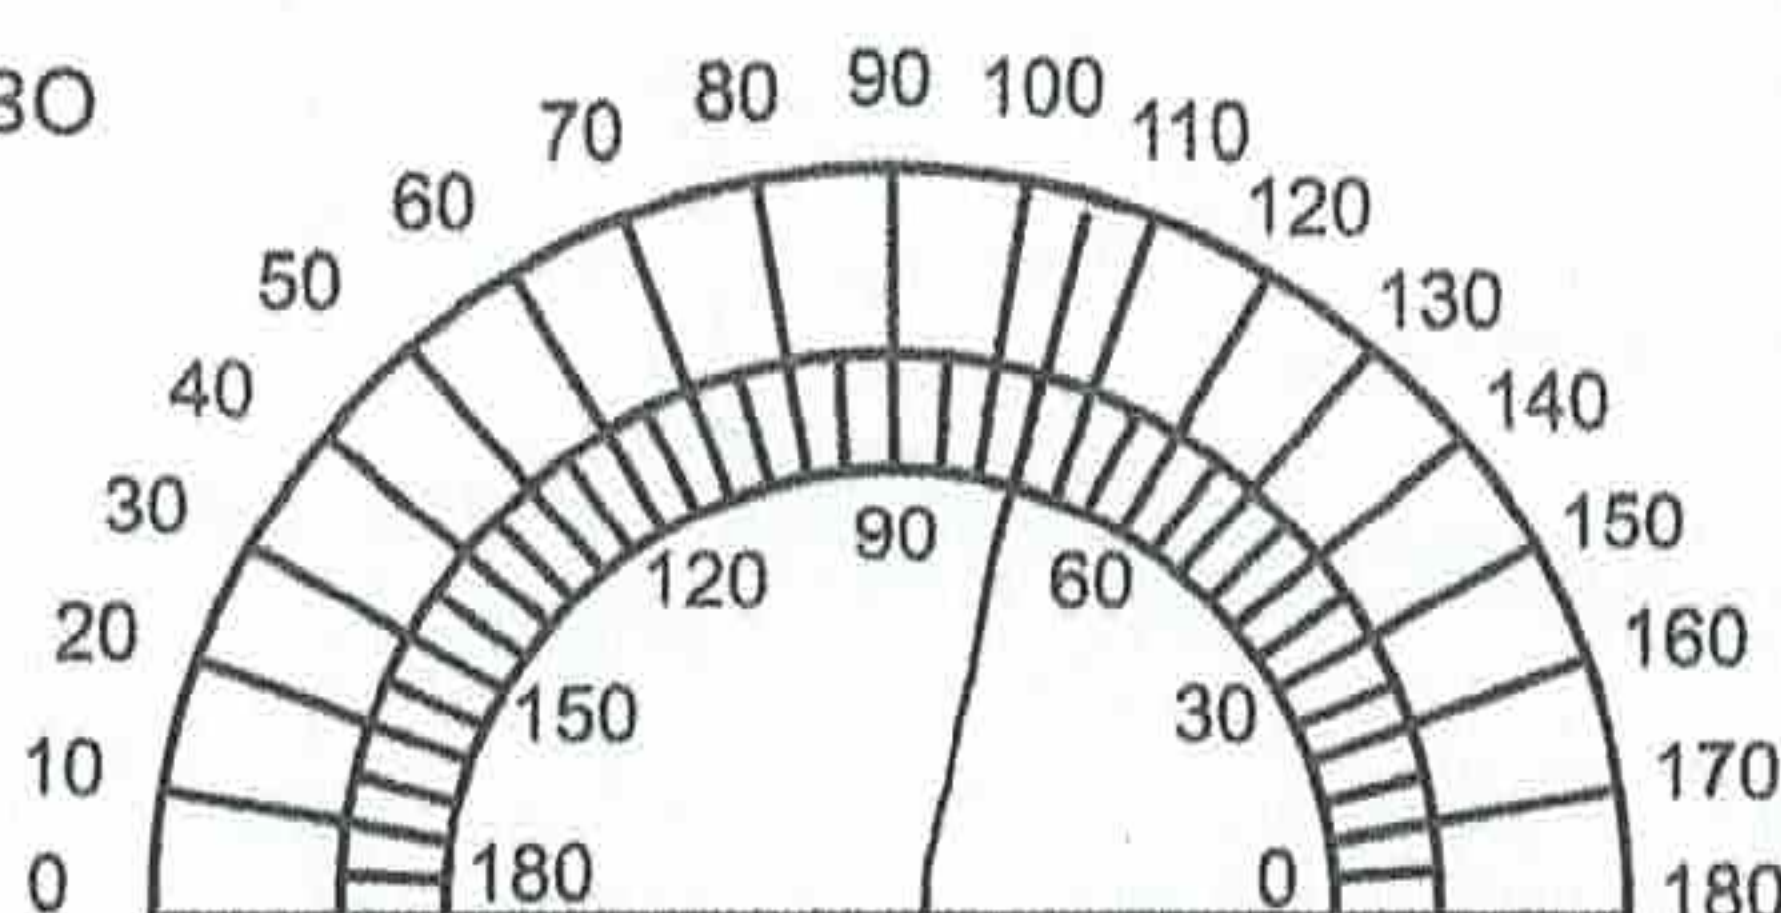

OCCHIO SINISTRO

Cil	Asse	Asse	Sf	Cil	Asse
-2.25	-0.75	75'	-2.25	-0.75	75' T430
A PERMANENZA					
-0.25	-0.75	75'	-0.25	-0.75	75'
PRISMA					
PRISMA					

Distanza interpupillare mm. LENTI ANTI-RIFLESSO

Note 8 TIPO OFFICE

A.S. Friuli Occidentale (ASFO)
S.C. Oculistica
73175 - dott.ssa Maria Letizia Salvetat

Riportare la presente prescrizione nelle visite successive



Fattura

Ottica de Marco S.a.s.

VIA Sclavons, 60/b
33084 Cordenons (PN)
Cod. Fisc. e P. IVA 01588410934
tel 0434-536369 - mail info@otticademarco.it
UNICREDIT fil. Cordenons IBAN IT63U0200864851000104853466
Reg.Min.Sal. ITCA01023176

Sig.**Perissinotto Alessandro****Via Meucci,3****33170 Pordenone (PN)**

Tipo di documento Fattura		Numero del documento 370/26	Data 04/07/2026	Codice fiscale PRSLSN77H16G914G		Partita IVA		Codice cliente 0008261A			
Doc. Commerciale / Scontrino 2149-0007 del 04/07/2026			Doc. Commerciale 2 / Scontrino 2		N. matr. reg. telematico 96MB3009600				Pagina 1 di 1		
			Banca di appoggio			Riferimento					
Codice a barre	Descrizione			Quantità	Prezzo Ivato	Sc. %	Sconto	Importo Ivato	IVA %	IVA Cod.	STS
	Montatura Osix 2011 Dispositivo medico con marcatura CE			1	260,00		65,00	195,00	4	04	AD
000000151375	Lente monofocale Hoya Huilux 1.6 blue control Dispositivo medico con marcatura CE			1	172,00		43,00	129,00	4	04	AD
000000151382	Lente monofocale Hoya Huilux 1.6 blue control Dispositivo medico con marcatura CE			1	172,00		43,00	129,00	4	04	AD

Contributo ambientale CONAI assolto

Pagamento avvenuto con mezzi tracciati.	Imponibile	% IVA	Cod. IVA	Imposta	Importo
	435,58	4	04	17,42	453,00
	Totale Imponibile			Totale IVA	Totale documento
	€ 435,58			€ 17,42	€ 453,00
Annotazioni		Esenzioni IVA			
Nostra banca di appoggio		UniCredit - Filiale di Cordenons IBAN IT63U0200864851000104853466			

Ottica de Marco S.a.s. VIA Sclavons, 60/b 33084 Cordenons - Cod. Fisc. e P. IVA 01588410934
tel 0434-536369 - mail info@otticademarco.it UNICREDIT fil. Cordenons IBAN IT63U0200864851000104853466

UC Mastercard
MC Cless

ACQUISTO

OTTICA DE MARCO SAS
VIA SCLAVONS, 60 B
CORTENONS

Eser. 397668500002
A.I.I.C. 000000000070
DATA 04/07/26 ORA 15:42
TML 30414064 STAN 000291
Mod. Online CTLS ICC
PAN: *****4969
EXP: **** PanSeqN: 001
AUT. H63706 OPER. 000351
Mastercard contactless
A.ID A0000000041010 APPL Debit Mastercard
ATC 0053 TCC 380 TT 00TrCC 978 UN 2BD2DD04
TVR 0000048001 A.R.Q.C.0008F0B578E574E1
IAD0110A0400522000000000000000000000FF

IMPORTO € 453,00

--- COPIA CLIENTE ---
TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA
PIN VERIFIED

OTTICA DE MARCO SAS
DI DE MARCO M. & C.
VIA SCLAVONS 60/B
33084 CORTENONS (PN)
TEL. 0434-536369
P.IVA 01588410934

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Montatura vista	4%	260,00
Disp.Med.Marc.CE		
Sconto	4%	-65,00
Lente oftalmica	4%	172,00
Disp.Med.Marc.CE		
Sconto	4%	-43,00
Lente oftalmica	4%	172,00
Disp.Med.Marc.CE		
Sconto	4%	-43,00
TOTALE COMPLESSIVO		453,00
DI CUI IVA		17,42
PAGAMENTO ELETTRONICO		453,00
IMPORTO PAGATO		453,00

COD.FISC.: PRSLSN77H16G914G

04/07/26 15:45 DOC.N.2149-0007

RT96NB3009600

Componenti del Dispositivo Medico (occhiale correttivo) adattato ⁽¹⁾

1) Montatura

CE Si: Fascicolo tecnico presso il produttore
 Fornitore: Thema Optical Srl
 Calibro: 57 Ponte: 16 Colore: nero opaco

Marca/Modello: Osix 2011

2) Lenti Oftalmiche

Lente DX

CE Si: Fascicolo tecnico presso il produttore
 Fornitore: Hoya Lens Italia S.p.A.
 Marca: Hoya
 Indice: 1.6 Ø: 70 Cat.fil.: //
 Prodotto: Huilux 1.6

Lente SX

CE Si: Fascicolo tecnico presso il produttore
 Fornitore: Hoya Lens Italia S.p.A.
 Marca: Hoya
 Indice: 1.6 Ø: 70 Cat.fil.: //
 Prodotto: Huilux 1.6

Tratt.: blue control
 Colore: %
 Suppl.:

Tratt.: blue control
 Colore: %
 Suppl.:

Famiglia: monofocale

SFERA	CIL.	AX	PRISMA	BASE	s.d.i.
-1,00	-0,75	75			32,0

Famiglia: monofocale

(Tabo)	SFERA	CIL.	AX	PRISMA	BASE	s.d.i.
L						
M						
V	-1,00	-1,00	80			30,5

I componenti utilizzati sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazione e sono provvisti delle rispettive dichiarazioni di conformità UE, previsti dal Regolamento (UE) 2017/745.

L'adattamento del dispositivo medico è conforme alla norma UNI EN ISO 21987 ed è fornito:

[X] Come da prescrizione allegata (☐ NS) [] Come da Suo occhiale in uso su precedente prescrizione e destinato ad essere utilizzato da Perissinotto Alessandro C.F. PRSLSN77H16G914G con residenza in Pordenone (PN) Via Meucci,3 - CAP 33170
 L'ametrope è stato correttamente istruito all'uso e alla manutenzione del suddetto Dispositivo Medico.

Data 24/07/2026

Questa attestazione viene conservata per dieci anni.

Firma

Il sottoscritto Perissinotto Alessandro

DICHIARA

- Di aver ricevuto dall'ottico-optometrista copia della presente e le indicazioni d'uso elaborate, sulla base delle istruzioni d'uso fornite da fabbricanti dei componenti utilizzati, relativamente anche alle operazioni di manutenzione e pulizia. Ed inoltre di essere stato informato dei pericoli derivanti da una non corretta osservanza delle istruzioni d'uso.
- Di essere stato informato che la Dichiarazione di Conformità dei componenti utilizzati è reperibile presso i fabbricanti dei Dispositivi Medici utilizzati indicati nel presente documento.
- Di essere allergico a qualche materiale per montature: ☐ NO ☐ NON SA ☐ SI
- Di aver richiesto espressamente le lenti oftalmiche in vetro nonostante gli sia stato sconsigliato in quanto inadeguato alle sue prerogative: ☐ NO ☐ SI

Data 21/7/26

Firma

INDICAZIONI PER L'USO (estratte dalle istruzioni per l'uso dei DM utilizzati)

Leggere e conservare le seguenti indicazioni che aiuteranno a mantenere in perfetta efficienza l'occhiale correttivo.

Descrizione del prodotto:

- L'occhiale che è stato fornito è un dispositivo medico adattato in base caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche di un singolo soggetto, e come tale è destinato ad un singolo utente.
- Non è un occhiale protettivo.
- Non è un occhiale da sole, se non diversamente indicato.
- L'occhiale correttivo adattato non è destinato a condizioni d'uso estreme, che potrebbero determinare un danneggiamento al dispositivo ed un rischio per il portatore (attività sportive, attività lavorative con proiezione di sostanze e materiali, ecc.) se non diversamente indicato.

Avvertenze:

- evitare di appoggiare l'occhiale con le lenti rivolte su superfici di appoggio, piani di lavoro, sedili, onde evitare danneggiamenti accidentali,
- evitare di coricarsi o di addormentarsi con l'occhiale calzato,
- riporre sempre l'occhiale nella custodia dopo l'uso,
- se l'occhiale è realizzato per la visione per vicino non è idoneo per altri scopi.

IMPORTANTE:

controllare quale classe di filtro è stata indicata per la colorazione del vostro occhiale correttivo adattato:

Filtro classe 0 = idoneo guida notturna e diurna

Filtro classe 1 = idoneo solo guida diurna

Filtro classe 2 = idoneo solo guida diurna

Filtro classe 3 = idoneo solo guida diurna

Filtro classe 4 = non idoneo per la guida (né diurna né notturna)

ATTENZIONE:

L'uso di occhiali in veicoli muniti di air-bag può essere pericoloso se si utilizzano lenti minerali non temperate. L'impatto con l'air-bag in portatori di occhiali può presentare rischi.

Indicazioni per un uso corretto:

- calzare l'occhiale e rimuoverlo dal viso impugnando entrambe le aste,
- se si evidenziano modificazioni dell'assetto dell'occhiale sul viso (l'occhiale calza diversamente da come impostato dall'ottico-optometrista), tornare dall'ottico per un riassetto dell'occhiale,
- prestare attenzione nello svolgimento di gesti quotidiani che potrebbero interagire con l'occhiale,
- se non è possibile riporre l'occhiale nell'astuccio, evitare di appoggiarlo con le lenti a contatto con superfici, corpi o sostanze,
- non dimenticare l'occhiale in materiale plastico vicino a fonti di calore e non sottoporlo a condizioni ambientali a rischio, come nel caso di sauna, casco da parrucchiere, cruscotto auto esposto al sole, ecc.

Manutenzione:

- sottoporre a periodica verifica il serraggio delle viti su anelli ed aste della montatura, per prevenire fuoriuscite accidentali delle lenti,
- sostituire placchette e terminali in gomma in caso di rottura.

Pulizia:

- usare per la pulizia solo i prodotti consigliati e detergenti neutri liquidi ed asciugarlo con tessuto appropriato,
- in mancanza dei prodotti consigliati ricorrere ad acqua,
- non usare agenti aggressivi neppure alcool o detergenti non specifici, se non diversamente indicato.

Va ricordato che una correzione o un mezzo di compensazione non possono restare invariati per tutta la vita, e quindi saranno necessari aggiornamenti periodici o quanto meno periodici controlli.

(1) In base all'art. 2 punto 3) Regolamento (UE) 2017/745.